



# 咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

## 检定证书

证书编号：XYxy20230210号


送检单位	延安大学咸阳医院有限公司
计量器具名称	血压计
型号 / 规格	yuwell
出厂编号	30497136
制造单位	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
检定依据	JJG 270-2008 《血压计和血压表》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 李红梅

核验员 康玉斌

检定员 苏建东

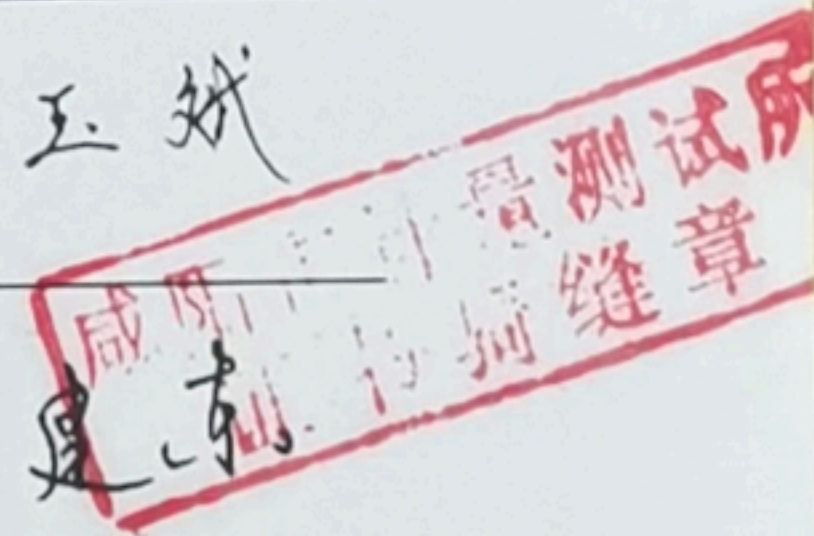

检定日期 2023年03月16日

有效期至 2023年09月15日

计量机构授权证书号：(陕)法计(2018)610110000号

地址：咸阳市秦皇中路6号

EMAIL: [xianyangjl@hotmail.com](mailto:xianyangjl@hotmail.com)

电话：029-33213535

邮编：712000

传真：029-38163105



# 咸阳市计量测试所

Xianyang Institute of Measurement and Testing

证书编号: XYxy20230210 号

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
血压计智能标准器	(0~40) kPa	0.2 级	XYj120230055	2024.02.13

溯源性: 本次检定使用的计量标准器均可溯源到国家计量基准

检定环境条件:

地点: 延安大学咸阳医院有限公司设备科

温度:	20°C	湿度:	42%RH	其他:	---
-----	------	-----	-------	-----	-----

## 检定结果/数据

1. 外观: 合格
  2. 零位: 合格
  3. 血压计的灵敏度: 合格
  4. 血压计气密性: 合格
  5. 示值误差: 允许值 $\pm 0.5$  kPa, 实际最大值 $-0.4$  kPa。
- 以下空白

未经本所书面授权, 不得部分复制本证书, 本证书的检定结果仅对所检定器具有效。